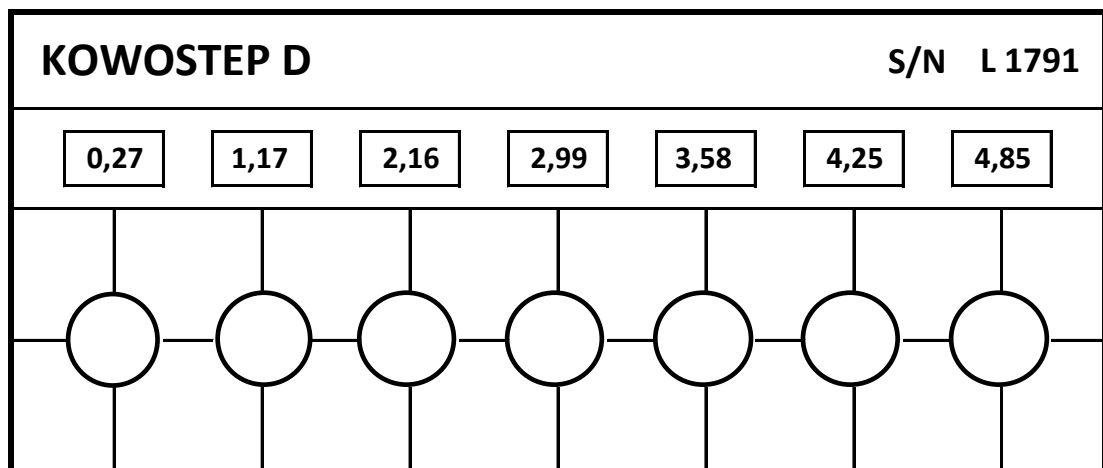


**PRÜFBERICHT Nr. / Datum**  
**TEST CERTIFICATE No. / Date**
**MUSTER**

 nach: **ASTM E1079**  
 according to:

 Prüfobjekt KOWOSTEP D Schwärzungstreppe  
 Test Object KOWOSTEP D Density Film Step Tablet  
 Referenznormal Schwärzungstreppe BAM-X001  
 Measuring Device X-Ray Film Step Tablet BAM-X001

 Serien-Nr. **L 1791**  
 Serial No.  
 Serien-Nr. **19-1991**  
 Serial No.


Stufe / Step	1	2	3	4	5	6	7
Optische Dichte (D) Optical Density (D)	0,27	1,17	2,16	2,99	3,58	4,25	4,85

zulässige  
Abweichungen  $\Delta D = +/- 0,05$

Die auf der KOWOSTEP D Schwärzungstreppe angegebenen Werte für die optische Dichte (D) wurden durch direkten Vergleich mit der oben genannten BAM Schwärzungstreppe ermittelt.

*Die BAM Schwärzungstreppe ist rückführbar auf das NIST Standard Reference Material.*

Values for optical Density (D) given on KOWOSTEP D Density Film Step Tablet had been determined by direct comparison with above named BAM X-Ray Film Step Tablet.

*BAM X-Ray Film Step Tablet is traceable to NIST Standard Reference Material.*

**Gültigkeit der Kalibrierung / Validity of Calibration: 3 Jahre / 3 years bis / until: 31.12.1902**

**KOWOTEST Gesellschaft für Prüfausrüstung mbH**

 Solinger Strasse 186  
 40764 Langenfeld / Germany  
 fon +49-2173-22383 fax +49-2173-22335  
[info@kowotest.de](mailto:info@kowotest.de)

 Langenfeld, 0  
 Abteilung QC-SC / Department QC-SC

 Unterschrift  
signature

 Stempel  
stamp

OK ✓

